


PS2: L'evoluzione del servizio di manutenzione

Eliminare gran parte delle cause di interruzione dei servizi dell'Ospedale è oggi possibile grazie alla gestione integrata del ciclo di vita delle apparecchiature tecniche e ad un servizio di manutenzione preventiva basato sulla rilevazione puntuale dei dati di funzionamento di ogni apparecchiatura.




Con PS2 ogni apparecchiatura è monitorata 24x7



Sistema PS2 presso Ospedale

- Sicurezza AES 128 BIT
- Dispositivi di rilevamento dati di funzionamento apparati
- Cruscotto di supervisione
- Informazioni e Ammortamento apparati

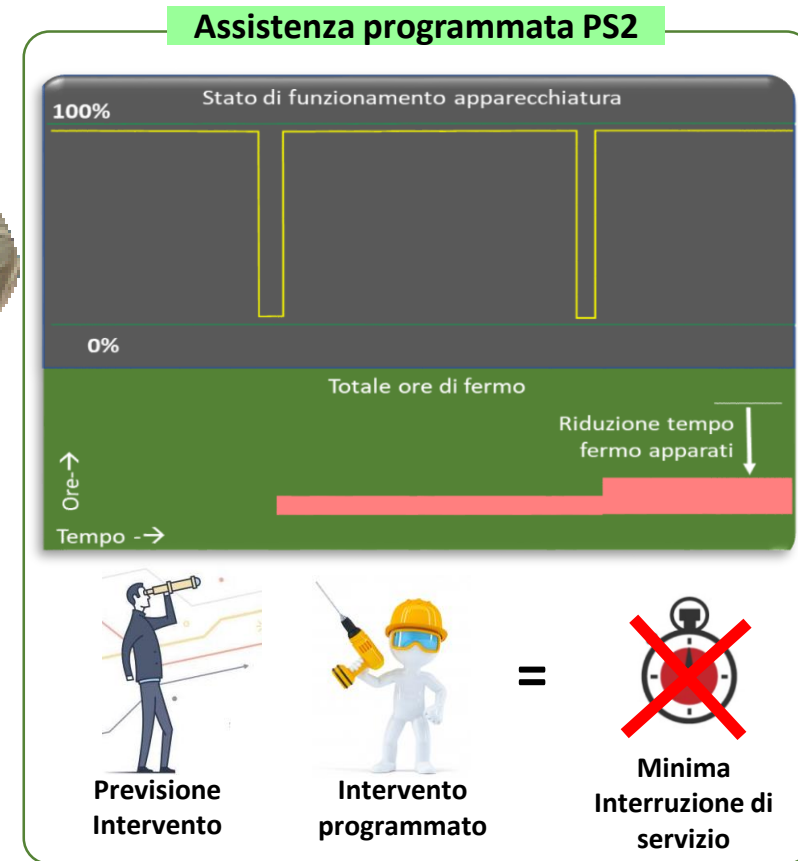

IL SISTEMA PS2


Il tecnico **addetto** e **qualificato** conosce per tempo le necessità di intervento, dispone dei pezzi di ricambio e di tutta la documentazione necessaria per effettuare interventi in conformità alle regolamentazioni EU 93/42.



Magazzino pezzi di ricambio



Documentazione tecnica delle apparecchiature



Scadenze e dati tecnici delle apparecchiature



Monitoraggio livello di servizio 24x7



eMail



SMS



Telegram

Alert di previsto intervento

L'avviamento del servizio PS2



Avvio del servizio PS2 da 6 a 12 settimane

| Attività | SETTIMANE | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A Identificazione apparecchiature | █ | | | | | | | | | | | |
| B Predisposizione sistema raccolta dati | | █ | | | | | | | | | | |
| C Start rilevamento dati di funzionamento | | | █ | | | | | | | | | |
| D Start Manutenzione programmata | | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ |